

BENA バイオリンオブリングケース 鍵の使用法について

※現在 BENA バイオリンケースに付属しています鍵は2種類あります。お持ちのケースの鍵に対応している説明をお読みください。

ケース出荷時の解除番号は、2種類ともに『0-0-0』です。

■ダイヤル式ロックの場合（ギャラックス VO-20 と同一タイプです）

【解除番号の設定方法】

1) オープンレバーを引きます。



2) オープンレバーを引いたままダイヤルを回し、お好みの3桁の数に合わせます。

(写真は2-0-0。ダイヤルが固い場合があります。回しにくい場合は、逆方向からお試してください。)



3) オープンレバーを戻し、新しい設定番号で再びオープンレバーが開くことを確認します。

4) ファスナーのつまみを片方ずつロック穴に押し込みます。




5) ダイヤルの数字を動かすとロックされ、オープンレバーは固定されます。



※解除番号を変える場合は上記の手順を繰り返して下さい。

■ TSA ロック設定方法

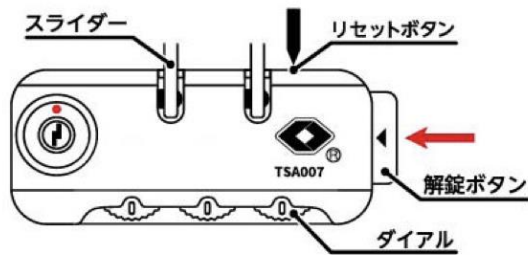

- 1) ダイヤルを解除番号に合わせます。※出荷時は 0-0-0 に設定されています。
- 2) 錠前側面のリセットボタンを先の尖ったもので軽く押しとカチッと音がして止まります。その状態でダイヤルを任意の番号にセットしてください。（セットした番号が今後の解除番号になります）
- 3) 解除ボタンを図の矢印の方向に押してください。リセットボタンが元に戻ったら完了です。

※リセットボタンは強く押し過ぎないようにしてください。解除ボタンを押してもリセットボタンが戻らない場合は、リセットボタンが引っかかっている可能性があります。その際はリセットボタンをずらす等して戻してください。

※変更後は、2でセットした番号以外では開かなくなります。新しい解除番号を忘れないようご注意ください。再度番号変更を行う場合は必ず解除番号に合わせてから上記手順を行ってください。解除番号以外の場合は、リセットボタンが動きません。

設定した新しい解除番号は、メモに必ず残す等してお忘れにならないようご注意ください。
解除番号を忘れた場合は、0-0-0から9-9-9まで回すか、
弊社サービスセンターまでお送り頂ければ、開錠いたします。（有料）

BENA ケース デジタル温湿度計の取り扱いについて


BENA ケースに付属のデジタル温湿度計は℃（摂氏）と°F（華氏）の表示を切り替えることが可能です。

- 1) ケースから温湿度計を取り外します。(写真①)
- 2) C / F ボタンをシャープペンの先等で押すと表示が切り替わります。(写真②)

表示が消えてしまったら電池交換が必要です。

- 1) ケースから温湿度計を取り外します。(写真①)
- 2) 背面の電池カバーを開け、電池（LR44）を交換します。(写真③、④)
- 3) ℃ / °F の表示を切り替える必要がある場合は、C / F ボタンをシャープペンの先等で押すと表示が切り替わります。(写真②)

写真①

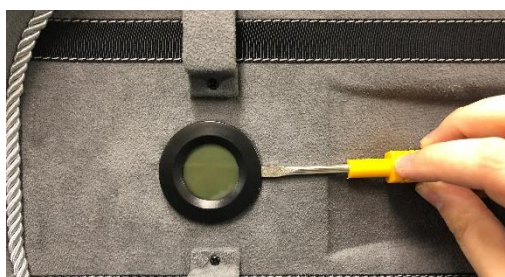

写真②



写真③



写真④

